Calibreurs FP-25 et FP-50

Guide de démarrage rapide

ALICAT SCIENTIFIC

A Halma company

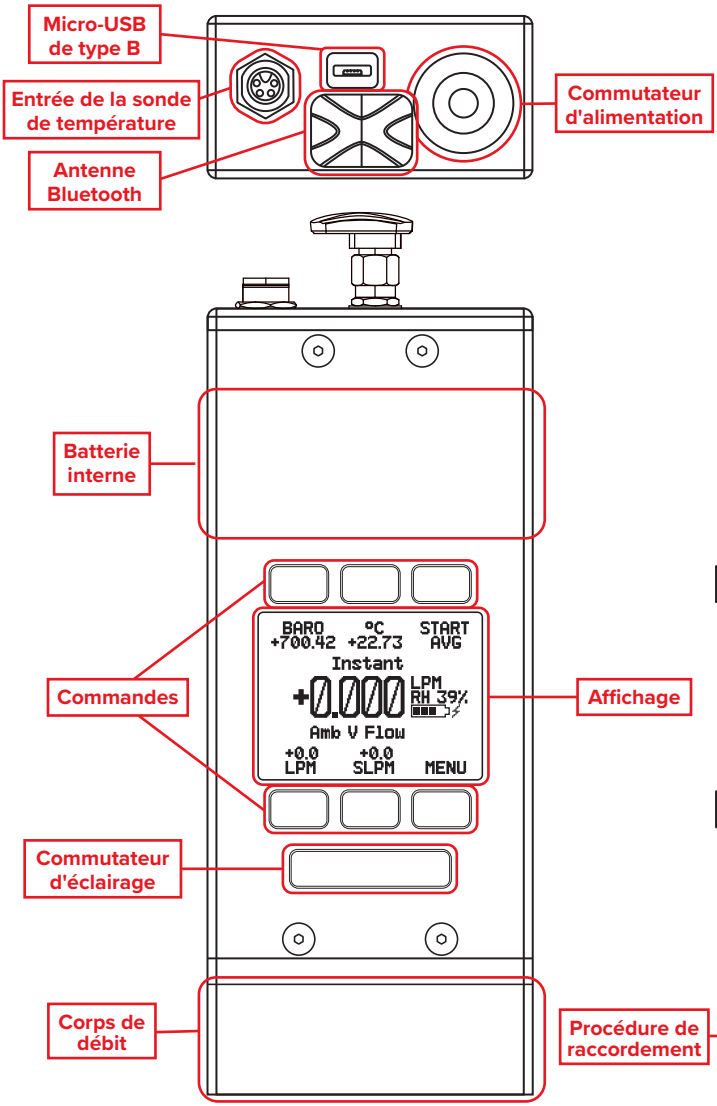

Téléchargez la version complète du manuel : **alicat.com/fr/manuel**

Ré-étalonnage Annuel • Dépannage • Questions :
+1 520-290-6060 • info@alicat.com

Ce carton comprend :

- Étui rigide Pelican personnalisé
- Calibreur de débit
- Sonde de température externe de 6'avec connecteur de verrouillage M8
- Adaptateur mural USB pour la recharge
- Antenne Bluetooth avec connecteur SMA fileté
- Raccords1/4" NPT avec joints mécaniques pour une connexion directe aux tubesinférieurs de l'échantillonneur d'air de 1 1/4" OD
- Câble Micro-USB vers USB pour la recharge et les communications
- Adaptateurà pointe de 1/4" NPT (pointe de ¼") avec joint mécanique
- Certificat d'étalonnage traçable au NIST

Démarrez :

1

Alimentation électrique

La batterie a été partiellement chargée avant l'expédition. Une fois complètement chargée, elle a une autonomie de 18 heures. Utilisez le câble d'alimentation fourni pour une recharge plus rapide.

2

Tare

Avant d'installer l'appareil dans votre mécanisme, appuyez sur le bouton de **TARE FLOW** sur l'écran principal. Cela réinitialisera (tare) votre appareil.

3

Option : Configuration de la moyenne

Étant donné que l'appareil est très sensible, le calcul de la moyenne des relevés peut minimiser les relevés non désirés de son environnement. Ouvrir **MENU → SETUP → AVERAGING TIME**. L'appareil ajoute 1000 mesures à la moyenne, par seconde.

Vous êtes prêt à vous connecter :

4

Assurez-vous que le flux va dans le même sens que la flèche sur votre appareil. Pour une meilleure précision, utilisez la sonde de température pour toutes les mesures.

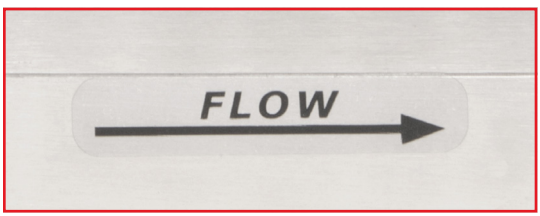

5

Téléchargez l'application Alicat Connect sur Google Play ou l'App Store et commencez votre calibrage !

App Store	Google Play

Téléchargez la version complète du manuel : **alicat.com/fr/manuel**

Ré-étalonnage Annuel • Dépannage • Questions :
+1 520-290-6060 • info@alicat.com

DOC-MANUAL-FP25-QUICK-US-FR
Rév 0 • 2021-12-13